

セレベント[®]25[®]ロタディスク[®] セレベント[®]50[®]ロタディスク[®] フルタイム[®]50[®]ロタディスク[®] フルタイム[®]100[®]ロタディスク[®] フルタイム[®]200[®]ロタディスク[®] 包装変更のお知らせ

グラクソ・スミスクライン株式会社

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび下記のとおり**セレベント[®]25[®]ロタディスク[®]**、**セレベント[®]50[®]ロタディスク[®]**、**フルタイム[®]50[®]ロタディスク[®]**、**フルタイム[®]100[®]ロタディスク[®]**、**フルタイム[®]200[®]ロタディスク[®]**の包装を変更いたしますのでご案内申し上げます。

先生方にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記


1 変更内容

販売名	包装	変更内容			
		ディスク		吸入器	使用説明書
		GS1コード 表示追加*	デザイン変更	形状・ デザイン変更	ディスク、 吸入器の 変更に伴う変更
セレベント25 ロタディスク	4ブリスター×28	○	○	○	○
セレベント50 ロタディスク	4ブリスター×28	○	○		
フルタイム50 ロタディスク	4ブリスター×28	○	○	○	○
フルタイム100 ロタディスク	4ブリスター×28	○	○		
フルタイム200 ロタディスク	4ブリスター×28	○	○		

*:平成24年6月29日付薬食安発0629第2号および医政経発0629第2号の「「医療用医薬品へのバーコード表示の実施要綱」の一部改正について」に基づき、ディスクにGS1コード(調剤包装単位)を表示いたします。


中面もご覧ください▶

■GS1コード(調剤包装単位)

販売名	調剤包装単位	GS1コード(調剤包装単位)
セレベント25ロタディスク	ディスク	 (01)04987246919012
セレベント50ロタディスク	ディスク	 (01)04987246919036
フルタイド50ロタディスク	ディスク	 (01)04987246917063
フルタイド100ロタディスク	ディスク	 (01)04987246917070
フルタイド200ロタディスク	ディスク	 (01)04987246917087


■ディスク

セレベント25ロタディスク

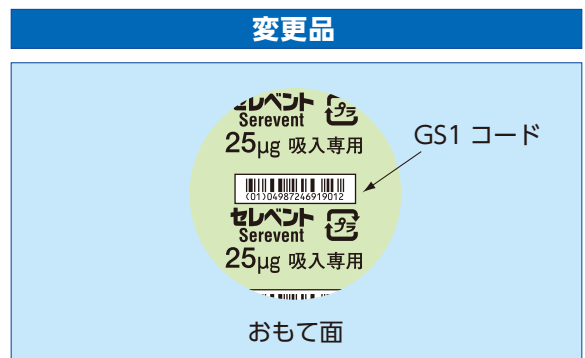


- ・ディスクサイズの変更はありません。
- ・ディスクのうら面の変更はありません。

セレベント50ロタディスク

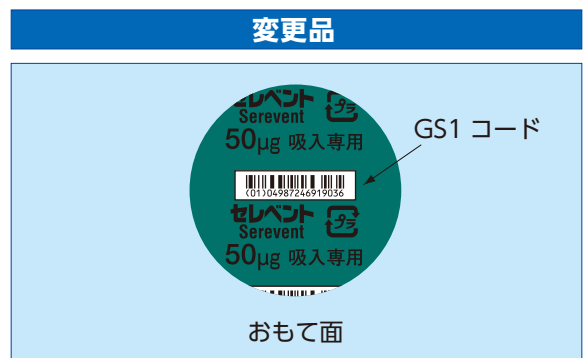

- ・ディスクサイズの変更はありません。
- ・ディスクのうら面の変更はありません。

フルタイド50ロタディスク

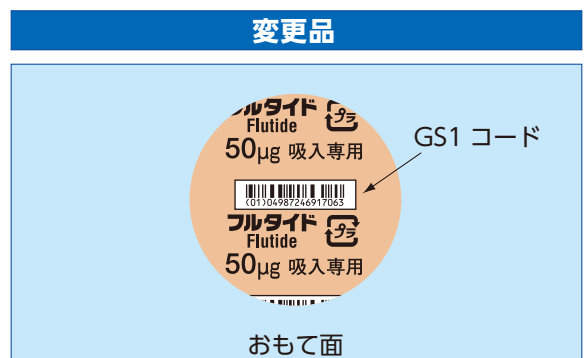


- ・ディスクサイズの変更はありません。
- ・ディスクのうら面の変更はありません。

フルタイム100ロタディスク



- ・ディスクサイズの変更はありません。
- ・ディスクのうら面の変更はありません。



フルタイム200ロタディスク

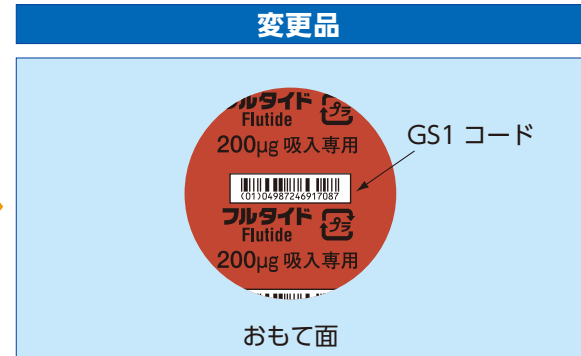

- ・ディスクサイズの変更はありません。
- ・ディスクのうら面の変更はありません。


吸入器

セレベントロタディスク

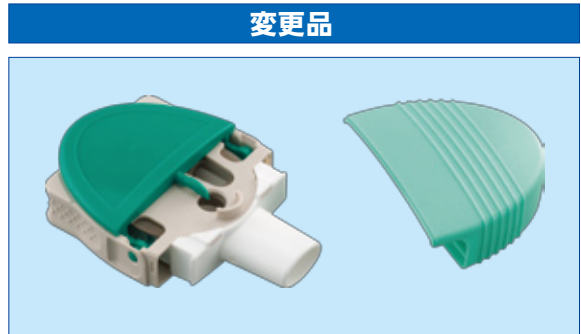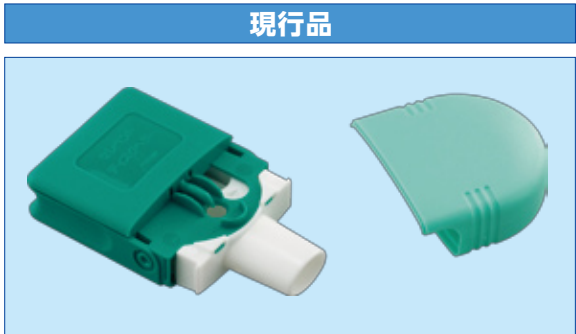

- ・セレベントロタディスクの補充用の吸入器も同様に変更致します。
- ・吸入器変更に伴い吸入器清掃用のブラシを削除致します。

フルタイムロタディスク

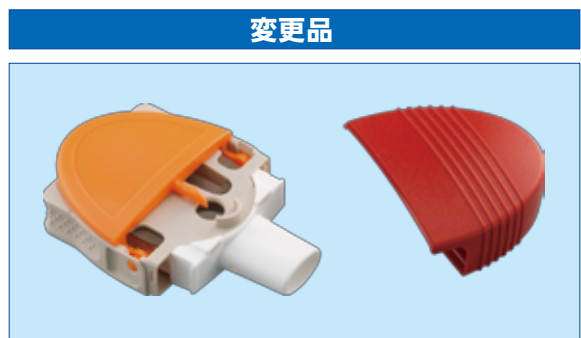

- ・フルタイムロタディスクの補充用の吸入器も同様に変更致します。
- ・吸入器変更に伴い吸入器清掃用のブラシを削除致します。

■ 使用説明書

ディスク・吸入器の変更に伴い記載内容を変更いたしました。

変更後(代表例:フルタイムロタディスク)



2 変更ロット、出荷予定時期


販売名	包装	変更ロット	出荷予定時期
セレベント25ロタディスク	4ブリスター×28	0088	2014年4月中旬
セレベント50ロタディスク	4ブリスター×28	0276	2014年6月中旬
フルタイム50ロタディスク	4ブリスター×28	未定	未定
フルタイム100ロタディスク	4ブリスター×28	2172	2014年6月上旬
フルタイム200ロタディスク	4ブリスター×28	1253B	2014年5月中旬

流通在庫の関係から出荷時期が前後する場合がありますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。最新情報は弊社ホームページ(<http://glaxosmithkline.co.jp>)「医療関係のみなさま」の「改訂のお知らせ」をご覧ください。


3 対応

しばらくの間、カートンに以下のカードを貼付いたします。

表紙

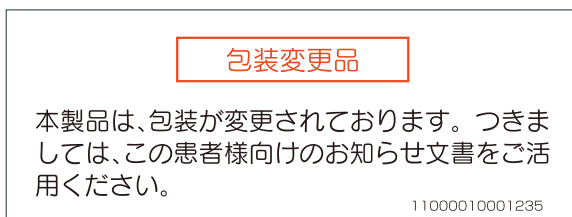

患者様向けカード

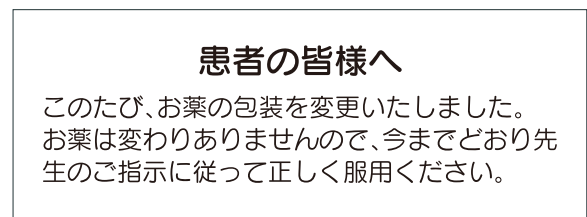

サイズ:80×30mm
4枚綴り

以上