

2018.9

包装変更のお知らせ

セレベント25ロタディスク

セレベント50ロタディスク

フルタイム50ロタディスク

フルタイム100ロタディスク

フルタイム200ロタディスク

グラクソ・スミスクライン株式会社

謹啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社が販売しておりますセレベント25ロタディスク、セレベント50ロタディスク、フルタイム50ロタディスク、フルタイム100ロタディスク、フルタイム200ロタディスクの包装を変更いたします。

先生方にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

記

謹白

1 変更内容

販売名	包装	変更内容
セレベント25ロタディスク	4ブリスター×28 (25 μ g/ブリスター)	・カートンのGS1コードを変動情報入りGS1コードに変更いたします (GS1コード表示面のデザイン変更) ・吸入器のピロー包装の形態を変更いたします
セレベント50ロタディスク	4ブリスター×28 (50 μ g/ブリスター)	
フルタイム50ロタディスク	4ブリスター×28 (50 μ g/ブリスター)	
フルタイム100ロタディスク	4ブリスター×28 (100 μ g/ブリスター)	
フルタイム200ロタディスク	4ブリスター×28 (200 μ g/ブリスター)	

■ 変動情報入りGS1コード


カートンのGS1コードを変動情報入りGS1コードに変更いたします。

これに伴いGS1コード表示面のデザインを変更いたします。


変更前

変更後

代表例:フルタイム100ロタディスク

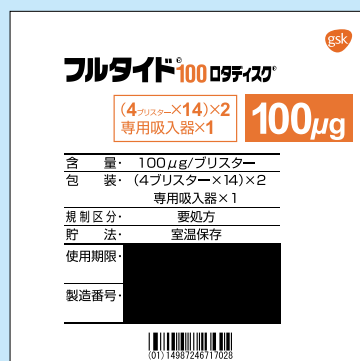

カートン GS1コード表示面

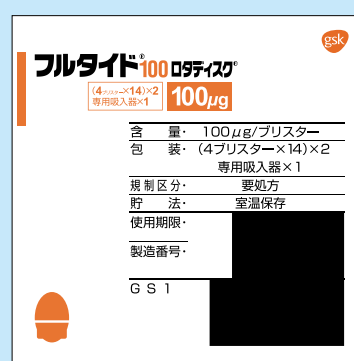


カートン GS1コード表示面

カートンサイズの変更はありません。

裏面もご覧ください▶

■ 吸入器ピロー包装

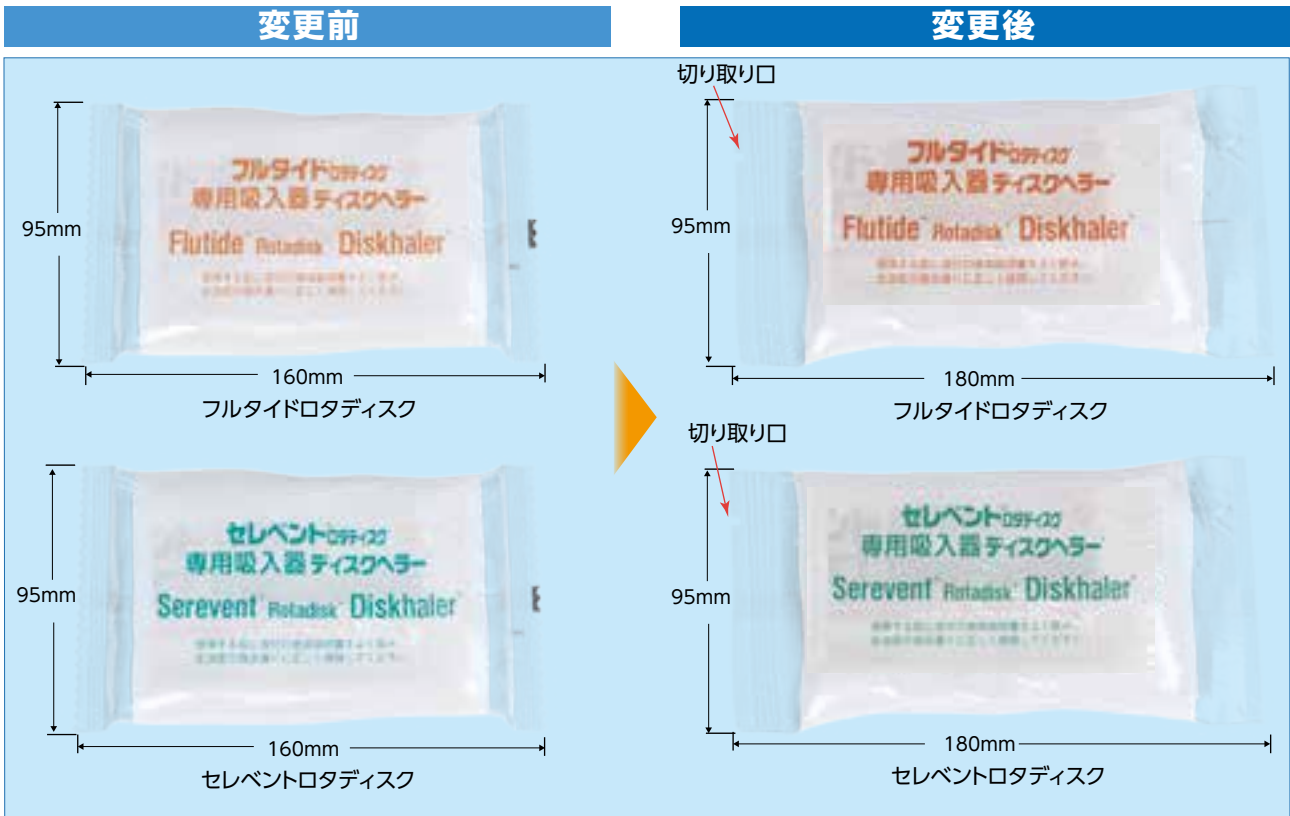

- ・セレベントロタディスク、フルタイドロタディスクいずれも表示の変更はありません。
- ・吸入器、使用説明書の変更はありません。

2 変更ロット、出荷予定時期

販売名	包装	統一商品コード	変更ロット	出荷予定時期
セレベント25ロタディスク	4ブリスター×28 (25 μ g/ブリスター)	246719018	未定	未定
セレベント50ロタディスク	4ブリスター×28 (50 μ g/ブリスター)	246719025	未定	未定
フルタイド50ロタディスク	4ブリスター×28 (50 μ g/ブリスター)	246717014	未定	未定
フルタイド100ロタディスク	4ブリスター×28 (100 μ g/ブリスター)	246717021	9J4E	2018年10月中旬
フルタイド200ロタディスク	4ブリスター×28 (200 μ g/ブリスター)	246717045	未定	未定

流通在庫の関係から出荷時期が前後する場合がありますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
 なお、未定品の変更ロット、出荷予定時期につきましては弊社ホームページ
 (<https://www.healthgsk.jp>)「製品情報」の「包装変更のお知らせ」をご覧ください。